
RG MEDICAL

INDUSTRIA ALEMANA
CE / ISO 9001

2026
Cátalogos de productos

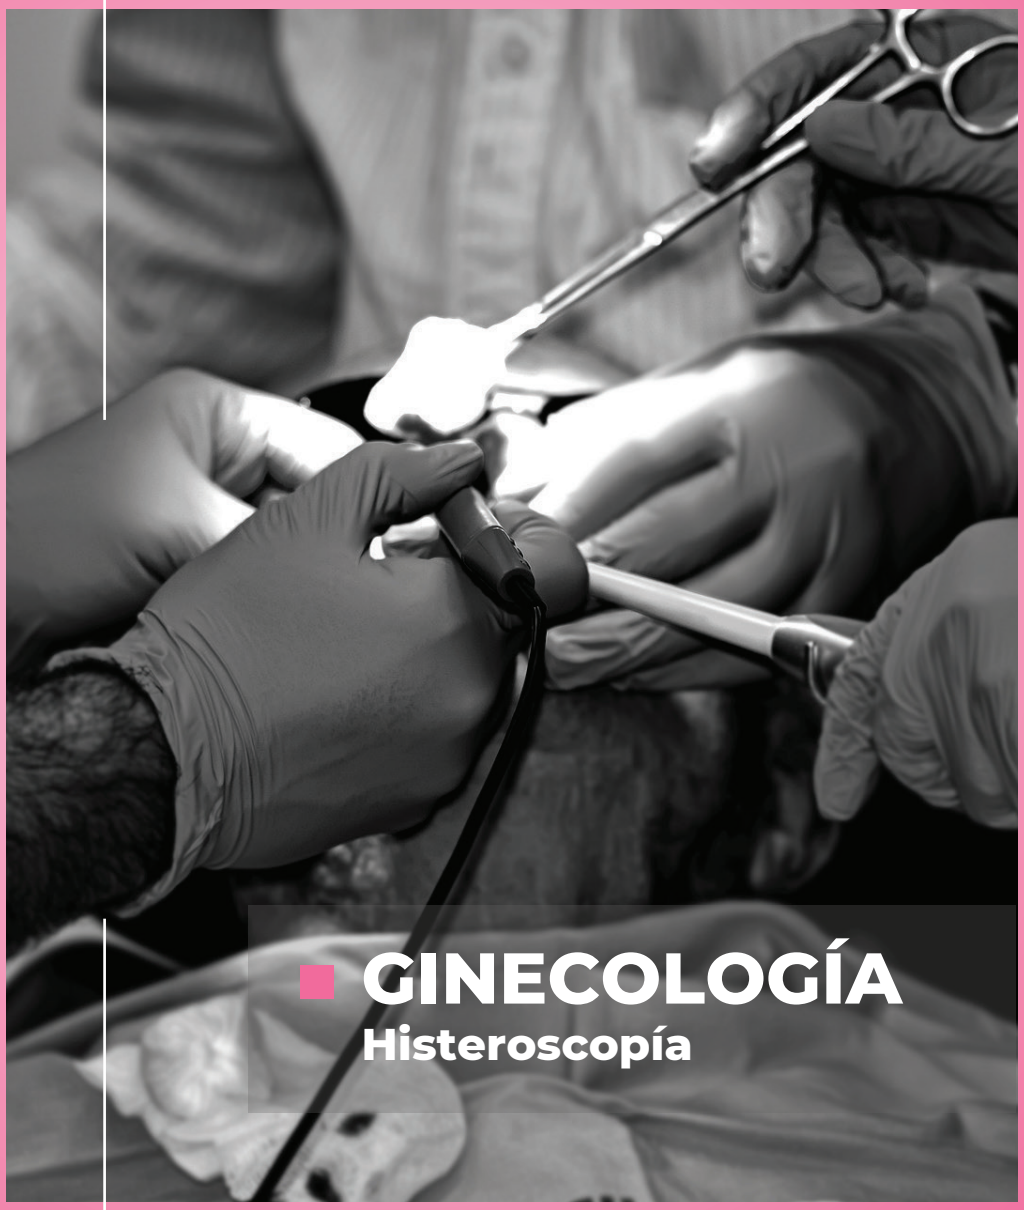

GINECOLOGÍA
Histeroscopía

Desarrollado y fabricado en Alemania.

RG Medical USA, Inc. Bulnes 1985 - 2° "5" - Palermo, Buenos Aires, Argentina
+54 9 11 2693-8766
www.rgmed.com

▪ MONITORES MÉDICOS



- Tamaño de pantalla 23,8 "
- Resolución 1920 x 1080
- Brillo 600cd / m '
- Profundidad de color
- 16,7 millones de colores
- Ángulo de visión 78/178
- Tiempo de respuesta (GtoG) 14ms

M-**238CL1**

▪ CÁMARAS

Cámara inalámbrica de 1080p



- Sin USB
- Software libre
- Imágenes / Grabación

EOC-23

▪ INSUFLADOR DIGITAL



- Insuflador digital 40 litros
- Pantalla táctil
- Modo día y noche

E-**IN40**

Cámara USB 1080p + LED de 10W



- Con USB
- Software libre
- Imágenes / Grabación
- LED

EC-USB1
EC-USB1 L

▪ COMBO CÁMARA FULL HD

Cámara 4K + Fuente de luz LED de 200WGraba en 4K UHD 3840x2160



- LED 200
- Sensor CMOS de 1/2.8"
- Color: 0.1Lux@F1.2
- 3840x2160 / 60Hz 4K UHD
- Salida 12G-SDI / 4K
- Salida HDMI 2.0 (4K)
- Vídeo compuesto C-Video
- 5300 K
- Ancho: 27 cm / Fondo: 32 cm / Alto: 12 cm

Código: C4K-L200

*El set incluye cámara, clable universal y equipo.

■ NUEVO DUO MONO-BIPOLAR 15, 17 Y 19 Fr.

Endoscopia Ø 2,9 mm



15 Fr.

Set completo 15 Fr	U1-530-15
Tubo interior 15 Fr	U1-532-15
Tubo exterior 15 Fr.	U1-534-15
Obturador 15 Fr.	U1-580-15
Elemento de trabajo	U1-300-15



17/18 Fr.

Set completo 17/18 Fr	U1-530-17
Tubo interior 17 Fr	U1-532-17
Tubo exterior 18.5 Fr.	U1-534-17
Obturador 17 Fr.	U1-580-17
Elemento de trabajo	U1-300-17



19/22 Fr.

Set completo 19/22 Fr	U1-530-19
Tubo interior 19 Fr	U1-532-19
Tubo exterior 22 Fr.	U1-534-19
Obturador 19 Fr.	U1-580-19
Elemento de trabajo	U1-300-19

■ DUO MONO-BIPOLAR 22 y 24 Fr.

Endoscopia Ø 4mm



22/24Fr.


Set completo 22/24 Fr	U1-530-22
Tubo interior 22 Fr	U1-532-22
Tubo exterior 24 Fr.	U1-534-22
Obturador 22 Fr.	U1-580-22
Elemento de trabajo	U1-300-22



24/26 Fr.

Set completo 24/26 Fr	U1-530-24
Tubo interior 24 Fr	U1-532-24
Tubo exterior26 Fr.	U1-534-24
Obturador 24 Fr.	U1-580-24
Elemento de trabajo	U1-300-24

ELEMENTO DE TRABAJO

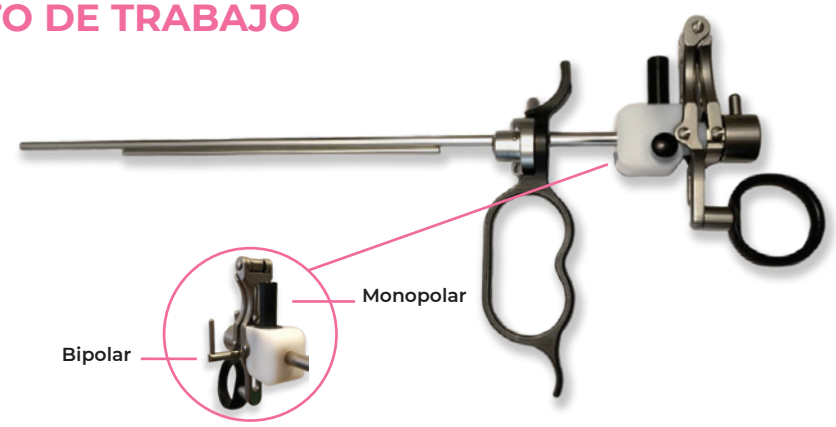

Unidad de trabajo, pasiva, bipolar

Bipolar pasivo estándar

15 Fr.	U1-300-15
17 Fr.	U1-300-17
19 Fr.	U1-300-19
22 - 24 Fr.	U1-300-22

Unidad de trabajo, activa, Bipolar

Estándar

15 Fr.	U1-310-15
17 Fr.	U1-310-17
19 Fr.	U1-310-19
22 - 24 Fr.	U1-310-22

ELECTRODOS

Electroo de corte, 30°



15 Fr.	U1-200-15
17 Fr.	U1-200-17
19 Fr.	U1-200-19
22 Fr.	U1-400-22
24 Fr.	U1-400-24

Electrodo de corte recto



15 Fr.	U1-202-15
17 Fr.	U1-202-17
19 Fr.	U1-202-19
22 Fr.	U1-402-22
24 Fr.	U1-402-24

Banda de corte retrograda



17 Fr.	U1-204-17
19 Fr.	U1-204-19
22 Fr.	U1-404-22
24 Fr.	U1-404-24

Electrodo cuchillo



15 Fr.	U1-206-15
17 Fr.	U1-206-17
19 Fr.	U1-206-19
22 Fr.	U1-406-22
24 Fr.	U1-406-24

Electrodo de bola de rodillo de 3mm



17 Fr.	U1-208-17
19 Fr.	U1-208-19
22 Fr.	U1-408-22
24 Fr.	U1-408-24

Electrodo de bola de rodillo de 5mm




17 Fr.	U1-209-17
19 Fr.	U1-209-19
22 Fr.	U1-409-22
24 Fr.	U1-409-24

▪ AUTOCLAVE, 134° C / 273° F




Ángulo de visión	Ø 2.0 mm	Ø 2.9 mm	Ø 4.0 mm
0°	E020-240-00	E029-303-00	E040-303-00
12°	E020-240-12	E029-303-12	E040-303-12
30°	E020-240-30	E029-303-30	E040-303-30
70°	E020-240-70	E029-303-70	E040-303-70

▪ CAMISA DIAGNÓSTICA PARA HISTEROSCOPÍA

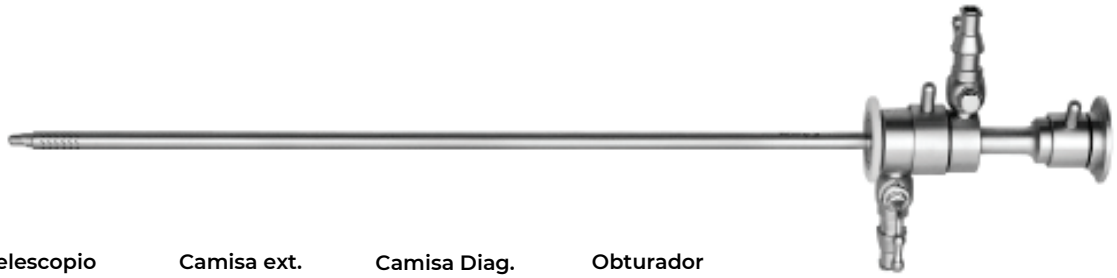

Telescopio	Camisa ext.	Camisa Diag.	Obturador
Ø 2.9 mm	G30-022-05	G30-022-06	G30-022-00
Ø 4.0 mm	G30-023-05	G30-023-06	G30-023-00

▪ CAMISA OPERATORIA DE BETTOCHI “STYLE”

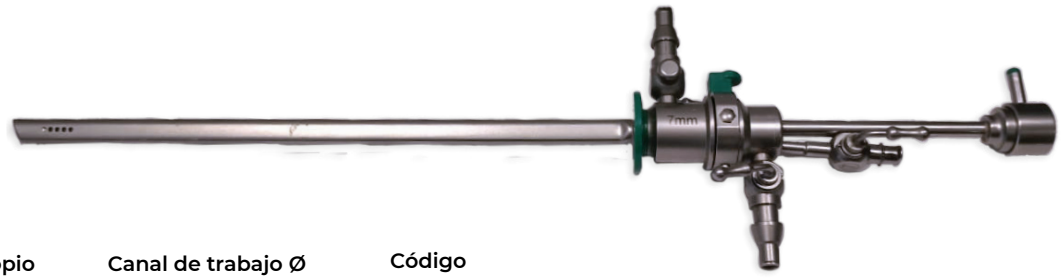

Telescopio	Canal de trabajo Ø	Código
Ø 2.9 mm	5 Charr./Fr	G30-018-05
Ø 4.0 mm	7 Charr./Fr	G30-018-07




▪ PINZAS



		SEMI RIGID 340 mm	FLEXIBLE 400 mm
Tijeras	5 Ch./Fr 7 Ch./Fr	G30-055-07 G30-055-05	G31-055-07 G31-055-05
Tijeras punta recta	5 Ch./Fr 7 Ch./Fr	G30-056-07 G30-056-05	G31-056-05 G31-056-07
Abrazadera de biopsia	5 Ch./Fr 7 Ch./Fr	G30-050-07 G30-050-05	G31-050-05 G31-050-07
Pinza caiman	5 Ch./Fr 7 Ch./Fr	G30-051-05 G30-051-07	G31-051-05 G31-051-07
Agarre de biopsia	5 Ch./Fr	G30-052-05	G31-052-05
Agarre de tenáculo	5 Ch./Fr	G30-053-05	G31-053-05
Electrodo de aguja	5 Ch./Fr	G30-054-05	G31-054-05
Electrodo de bola de coagulación	5 Ch./Fr	G30-057-05	G31-057-05

▪ ELECTRODOS LEEP



Electrodo Leep	Código	
5 mm x 5 mm	M90-001	
10 mm x 5 mm 10 mm x 7 mm 10 mm x 10 mm	M90-002 M90-003 M90-004	
15 mm x 5 mm 15 mm x 7 mm 15 mm x 8 mm 15 mm x 15 mm	M90-011 M90-012 M90-013 M90-014	
20 mm x 8 mm 20 mm x 10 mm 20 mm x 13 mm 20 mm x 15 mm 20 mm x 20 mm 20 mm x 20 mm	M90-021 M90-022 M90-023 M90-024 M90-025 M90-026	
Electrode cuadrado		
10 mm x 4 mm 10 mm x 8 mm	M90-031 M90-032	
Electrodo bola		
3 mm 5 mm	M90-051 M90-052	

▪ CABLE DE LUZ



Medidas	Código
Largo 180 cm	E1-035-18

▪ VIDEO COLPOSCOPIO



Video Colposcopio M99-001

▪ TISHER



Tischler	G30-070-01
Baby Tischler	G30-070-02
Kevorkian	G30-070-03

■ MINI FUENTE DE LUZ LED 100W



- LED DE 100W
- CALIDAD DE DISEÑO ALEMÁN
- + 20.000 HORAS
- AJUSTE AUTOMÁTICO INTENSIDAD DE LUZ

ESPECIFICACIONES

Tipo de luz	LED de 100 W
Puertos	Individual (Storz), otros adap. opcionales.
Control de int. de luz	Auto ajuste
Temperatura de color	6000-65000 °K
Vida útil de la matriz de LED	20.000 + Horas
Dimensiones	Los 9 x 12 x 7 cm
Perso	280 grs
Garantía	2 años
Código	E-L100

Garantía limitada: Se garantiza que los instrumentos de RG Medical estan libres de defectos en materiales y mano de obra durante la vida putil del instrumento. Cualquier instrumento que se encuentre defectuoso será reparado o reemplazado a discrecion de RG Medica. Esta garantia es nula si el insturmento no se ultiliza para el propósito quirurgico para el que fue diseñado o si recibe el servicio de alguien que no sea RG Medical.

*Tenga en cuenta que el fabricante solo proporciona una imagen de archivo para este grupo de productos. La apariencia del producto puede ser diferente. Los detalles especificos del producto se enumeran en la descripción.

▪ LUZ LED PORTÁTIL DE 10W



Funciones

Compacta y portátil, la bateria de litio incorporada permite que la mini fuente de luz fría portatil funcione mas de 2 horas despues de recargarse. Lo diseñamos y fabricamos para su uso con un endoscopio rigico o flexible.

Una caracteristica de seguridad particularmente bien concebida es el cambio automatico de la fuente de luz principal a la fuente de luz de repuesto en caso de falla de la fuente de luz.

Por lo tanto, la fuente de luz está siempre lista para uso de emergencia y contribuye a la seguridad del paciente.

N° Ref: E-L10P



▪ “MINI” LED 10w

N° Ref: E-HL10MP



Incluye:

- ▹ Dispositivo LED
- ▹ 2 baterias recargables
- ▹ Cargador
- ▹ Estuche de viaje pequeño opcional

N° Ref: E-L10P



▪ FRONTO LUZ

▪ 10W - Ultra brillante y ligero



* Opción para enfocar

Descripción	Código
Enfoque fijo	**E-HL10**
Con regulador de enfoque	**E-HL10F**

▪ 10W - Ultra brillante



Descripción	Código
10W - Ultra brillante	**E-HL10U**

▪ Led 5W - Inalámbrico



Descripción	Código
Led 5w - Inalámbrico	**E-HL5I**

Características

Aplicaciones:
Quirúrgica, para odontología, veterinaria

Tipo de iluminación:
LED

Otras características:
Con batería recargable, para lupa binocular, con fuente de luz portátil

Incluyen:



▹ Estuche de viaje porátil

▹ 1 Cargador

▹ 2 Baterías recargables de iones de litio

RG™ MEDICAL

Tecnología Alemana

RG Medical USA, Inc.
Bulnes 1985 - 2° "5" - Palermo, Buenos Aires, Argentina
+54 9 11 2693-8766
www.rgmed.com